



HYSIS MEDICAL

100 Impasse du Serpolet – ZAC Athelia II – 13704 LA CIOTAT – France

Tél. : 33 (0)4 42.83.80.10 - Fax : 33 (0)4 42 03 80 96

E-mail : info@hycare-medical.com / Site : <http://www.hycare-medical.com>

NOTICE TECHNIQUE

LAVE MAINS CHIRURGICAL

**EAU A COMMANDE MECANIQUE AU GENOU
SAVON A COMMANDE AU COUDE**

TRAITEMENT : PREFILTRATION A 1 μ

REFERENCES S1.FM - S2.FM – S2x2.FM

TABLE DES MATIERES

<u>I</u>	<u>IDENTIFICATION</u>	4
I.1	FABRICANT	4
I.2	MATERIEL	4
I.3	MANUEL	4
I.4	CARTE D'IDENTIFICATION	4
<u>II</u>	<u>UTILISATION ET CONSERVATION DU MANUEL</u>	5
II.1	UTILISATION	5
II.2	CONSERVATION	5
II.3	COPIES ET MISES A JOUR	5
<u>III</u>	<u>USAGE DE L'APPAREIL</u>	6
III.1	USAGE PREVU	6
III.2	CONTRE INDICATIONS D'UTILISATION	6
III.3	RISQUES RESIDUELS	6
<u>IV</u>	<u>DESCRIPTION DE L'APPAREIL</u>	7
IV.1	CARACTERISTIQUES	7
IV.1.1	STRUCTURE	7
IV.1.2	ORGANES DE DISTRIBUTION	7
IV.1.3	FILTRATION DE L'EAU	7
IV.1.4	ALIMENTATION EAU CHAUDE / FROIDE	7
IV.2	DONNEES TECHNIQUES	8
<u>V</u>	<u>MANUTENTION ET TRANSPORT</u>	9
V.1	CONDITIONS DE STOCKAGE	9
V.2	DIMENSIONS ET POIDS	9
V.2.1	EN CARTON	9
V.2.2	EN PALETTE	9
V.2.3	EN CAISSE	9
V.2.4	TRANSPORT	9
<u>VI</u>	<u>INSTALLATION</u>	10
VI.1	ESPACE MINIMUM NECESSAIRE	10
VI.2	VALEURS AMBIANTES ADMISSIBLES	10
VI.3	POSITIONNEMENT ET FIXATION	10
VI.4	ALIMENTATION HYDRAULIQUE - EVACUATION	11
VI.5	FILTRATION	11

<u>VII</u>	<u>FONCTIONNEMENT</u>	<u>12</u>
VII.1	PREPARATION ET MISE EN SERVICE	12
VII.2	UTILISATION	12
VII.3	PRECAUTIONS	13
<u>VIII</u>	<u>MAINTENANCE</u>	<u>14</u>
VIII.1	FILTRATION	14
VIII.1.1	REPLACEMENT DU PREFILTRE	14
VIII.1.2	STERILISATION ET REMPLACEMENT DU FILTRE (OPTION)	14
VIII.2	VERIFICATIONS PERIODIQUES	15
VIII.2.1	NETTOYAGE DES COLS DE CYGNES	15
VIII.2.2	SAVONNIERS	15
VIII.3	OPTION ASEPTISATION DES CONDUITES	15
VIII.4	MELANGEUR THERMOSTATIQUE	16
VIII.5	CONTRE-INDICATIONS DE MAINTENANCE	16

I IDENTIFICATION

I.1 FABRICANT

HYCARE MEDICAL
Zac Athélia II
100 Impasse du Serpolet
13704 La Ciotat
France

Tél. : 04.42.83.80.10
Fax : 04.42.03.80.96

I.2 MATERIEL

LAVE MAINS CHIRURGICAL

TYPE DE TRAITEMENT D'EAU : Préfiltration à 1 μ
MODELE : Commande mécanique au genou (eau) et coude (savon)
REFERENCE : S1.FM, S2.FM, S2x2.FM

I.3 MANUEL

EDITION : Janvier 2003
MISE A JOUR : Février 2010
REFERENCE : NT03-2

I.4 CARTE D'IDENTIFICATION

Chaque lave mains porte une carte d'identification reprenant les informations suivantes :

- Référence de l'appareil
- N° de série et année de construction
- Coordonnées fabricant

II UTILISATION ET CONSERVATION DU MANUEL

II.1 UTILISATION

Le présent manuel a été rédigé selon la norme EN 292-1 et reporte les instructions essentielles concernant :

- L'emballage
- Le stockage
- Le transport
- L'installation
- L'utilisation en toute sécurité

des lave mains S1.FM et/ou S2.FM, S2x2.FM

Sont également définis:

- L'utilisation prévue
- L'utilisation raisonnablement prévisible
- Les risques résiduels de l'appareil

comme prévu par la Directive 89/393/CE.

Le présent manuel s'adresse à toute personne autorisée et compétente quant à ce type d'appareil ainsi qu'aux installateurs et manutentionnaires.

II.2 CONSERVATION

Il est recommandé de conserver ce manuel pour toute réclamation future : pièces de rechange, problèmes techniques, attestations, etc.

Conservez ce manuel en bon état et toujours à portée de main pour une consultation aisée.

II.3 COPIES ET MISES A JOUR

Pour obtenir d'éventuelles copies et/ou mises à jour ainsi que toute information sur l'appareil, veuillez prendre contact avec notre bureau à l'adresse mentionnée § 1.1 en indiquant le type du manuel repris en § 1.3.

HYCARE MEDICAL se réserve le droit d'apporter toute modification qu'elle juge opportune sur l'appareil et/ou sur le manuel sans être tenue pour autant de mettre à jour les appareils ou manuels précédemment livrés.

III USAGE DE L'APPAREIL

III.1 USAGE PREVU

Les lave mains S1.FM et/ou S2.FM, S2x2.FM ont été conçus et fabriqués en conformité avec les Directives et les normes européennes et nationales en vigueur ; en respectant les exigences essentielles de sécurité prévues par les principales Directives 89/392/CEE (Directive sur les machines complétée par les directives 91/368/CEE, 93/44/CEE et 93/68/CEE), Directive 73/23/CEE (Directive sur la basse tension modifiée par la Directive 93/68/CEE), Directive 89/336/CEE (Directive sur la compatibilité électromagnétique modifiée par les Directives 92/3/CEE et 93/68/CEE).

L'utilisation des appareils est destinée seulement aux personnes autorisées et formées.

Les appareils ci-dessus mentionnés ont été conçus pour un usage uniquement professionnel.

Les lave mains S1.FM et/ou S2.FM, S2x2.FM sont destinés au **lavage chirurgical des mains** en bloc opératoire ou dans les services à risques.

III.2 CONTRE INDICATIONS D'UTILISATION

Ne pas utiliser le lave mains pour :

- le lavage de matériels, instruments ou autres parties du corps que celles mentionnées § III.1
- le vidage de seaux hygiéniques ou autres

III.3 RISQUES RESIDUELS

L'utilisateur ne doit pas :

- intervenir sur les mélangeurs eau chaude / eau froide

IV DESCRIPTION DE L'APPAREIL

IV.1 CARACTERISTIQUES

IV.1.1 STRUCTURE

- Bac polyester armé fibre de verre avec gelcoat de finition blanc et bonde à grille intégrée (écoulement libre).
La robinetterie eau est incorporée à l'ensemble.
- Commandes mécaniques au genou actionnant la robinetterie montées sur la façade du lave mains. Elles sont constituées par des tiges mobiles en plastique dur.
Ces commandes au genou sont temporisées : le temps d'écoulement est d'environ 5 secondes.

IV.1.2 ORGANES DE DISTRIBUTION

- Un ou deux distributeurs de savon commande au coude
- Un ou deux cols de cygne en laiton chromé dispensant l'eau démontables pour leur stérilisation

IV.1.3 FILTRATION DE L'EAU

L'eau est traitée par une préfiltration qui peut être, sur **option**, complétée par une filtration terminale.

- Préfiltration à 1 micron 10 pouces : la cartouche est logée dans un carter bleu dont la tête est fixée sur le châssis. Cette cartouche est interchangeable avec robinet d'isolement : Cf. Maintenance.
- Filtration terminale à 0,2 micron : une cartouche de filtration terminale peut être montée sur le col de cygne par l'intermédiaire d'un coupleur d'adaptation, l'étanchéité étant assurée par un joint en silicone. Une douchette plastique peut être adaptée à la base de la cartouche. L'ensemble cartouche + raccord est entièrement autoclavable. Cette cartouche est interchangeable : Cf. Maintenance.

IV.1.4 ALIMENTATION EAU CHAUDE / FROIDE

- Les lave mains S1.FM et S2.FM, S2x2.FM sont alimentés à partir d'un réseau d'eau chaude et d'eau froide par un mélangeur mitigeur thermostatique.
- La pression d'arrivée d'eau froide doit être rigoureusement égale à la pression d'arrivée d'eau chaude, ceci afin d'obtenir une bonne régulation (pression : 3 à 8 bars).
- Le débit d'eau peut être ajusté par un ou deux té(s) de réglage situé(s) à l'entrée du lave mains.

IV.2 DONNEES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES	S1.FM	S2.FM	S2x2.FM
Nombre de postes d'eau	1	2	2
Nombre de distributeurs de savon	1	1	2
Puissance absorbée en W	-	-	-
Encombrement mural en mm			
Largeur	875	1485	1485
Profondeur	600	600	600
Hauteur appui mural	920	920	920
Poids de l'appareil en kg	44	55	55
Profondeur de bac en mm	350		
Débit horaire par col de cygne et par poste d'eau	-		
Alimentation électrique	-		
Principe de commande eau	Commande mécanique au genou		
Principe de commande savon	Commande au coude		
Raccordement eau chaude/eau froide	1/2 " pas du gaz		
Raccordement au mélangeur thermostatique	Entre-axe 100 mm fileté mâle 1/2" pas du gaz		
Diamètre de vidange en mm	Siphon fourni 40		

Une pression minimum de 3 bars est nécessaire au bon fonctionnement de cet équipement.

V MANUTENTION ET TRANSPORT

V.1 CONDITIONS DE STOCKAGE

Température de stockage : > 5°C

Humidité : 80% maximum

Ne pas exposer le lave mains, même emballé, à l'action directe des perturbations atmosphériques .

V.2 DIMENSIONS ET POIDS

Le lave mains S1.FM et/ou S2.FM, S2x2.FM à la demande du client, peut être expédié :

V.2.1 EN CARTON

Carton triple cannelure avec flasques intérieures de calage.

V.2.2 EN PALETTE

Palettes bois 120x80cm.

V.2.3 EN CAISSE


Caisse de regroupement à claire-voie ou en bois pour expédition aérienne ou maritime.

Dimensions sur mesures.

Consulter HYCARE MEDICAL pour une offre de prix adaptée.

V.2.4 TRANSPORT

Ne pas traîner les cartons au sol mais les déposer sur un chariot à fourches ou un transpalette.
Déballer le lave mains près du site d'installation.

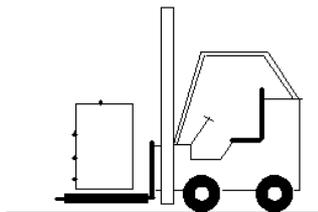

VI INSTALLATION

VI.1 ESPACE MINIMUM NECESSAIRE

Positionner le lave mains de sorte à garantir un espace nécessaire pour les opérations normales d'utilisation et de maintenance.

Il convient de prévoir

- face au lave mains, un espace minimum d'un mètre afin de permettre une utilisation aisée
- un espace de 30 centimètres de chaque côté du lave mains afin de permettre une maintenance aisée
- **option capotage** : voir attentes d'implantation sur schéma « Option capotage » annexé en fin de notice.

VI.2 VALEURS AMBIANTES ADMISSIBLES

Température de fonctionnement : 40°C maximum

Humidité : 80% maximum

VI.3 POSITIONNEMENT ET FIXATION

- Les lave mains modèles S1.FM et/ou S2.FM, S2x2.FM sont constitués d'une structure fixée sur un cadre métallique (châssis).
 - 2 pattes d'accrochage sont livrées séparément : elles sont à fixer au mur afin de pouvoir accrocher le châssis.
 - Ne pas oublier de placer la vis de fixation du cadre sur la patte soudée située dans la partie basse de l'appareil (modèles S2.FM et S2x2.FM seulement).
- Raccorder éventuellement le bac au mur par un joint pâte silicone pour faciliter le nettoyage.
- Visser les cols de cygne
- Le dosage du distributeur de savon est pré-réglé pour une capacité maximale de 1,5 ml/pression. Une réduction de dosage peut-être obtenue en tournant la vis de dosage graduellement.

VI.4 ALIMENTATION HYDRAULIQUE - EVACUATION

Avant de raccorder le lave mains il est indispensable de procéder à un rinçage des tubulures d'eau en attente afin d'éviter l'obstruction des diaphragmes limiteurs de débit des postes de distribution d'eau. Une éventuelle obstruction nécessiterait la dépose et la repose du lave mains.

Il est recommandé d'installer en amont des vannes de sécurité en ½ M

- Evacuation :
Raccorder le siphon d'évacuation de Ø 40 au tout à l'égout

Se référer impérativement au schéma d'implantation en fin de documentation.

VI.5 FILTRATION

- Préfiltration :
 - . Sortir le préfiltre de son emballage et l'installer dans le carter bleu
 - . Visser le corps du carter sur la tête fixée au châssis

Le préfiltre est alors prêt pour une utilisation d'une durée de ± 6 mois selon la qualité de l'eau
- Filtration (**option**) :
 - . Sortir le filtre de son emballage
 - . Cocher la première case sur la collerette
 - . Mettre le filtre sous sachet pour l'autoclavage
Autoclavage : 18 minutes à 135°C
 - . Sortir le filtre du sachet
 - . Mettre le filtre en place sur le coupleur en soulevant la bague de celui-ci puis en la rabaissant
 - . Faire couler l'eau

Le filtre est alors prêt pour utilisation d'une durée de 24 heures ou 48 heures maximum.

VII FONCTIONNEMENT

VII.1 PREPARATION ET MISE EN SERVICE

Oter toute éventuelle trace de saleté.

Vérifier les raccordements hydrauliques.

- Ouvrir les robinets d'arrêt pour mettre le lave mains en pression et s'assurer de l'étanchéité des joints. En effet, il est fréquent qu'après un stockage prolongé il soit nécessaire de resserrer les raccords afin de les rendre étanches.
- Remplir le flacon de savon chirurgical et appuyer sur le levier pour vérifier le bon fonctionnement de la distribution du liquide.
- Actionner les tiges plastiques vers l'extérieur du bac pour faire couler l'eau. Manœuvrer plusieurs fois pour amorcer le mécanisme. Un bouton rouge positionné sur le carter vous permettra d'effectuer si nécessaire une purge.
Si besoin est, vous pouvez modifier le débit au niveau du té de réglage en agissant en plus ou en moins sur sa vis.
- Procéder à une décontamination des canalisations : **Cf.§VIII.3 Option aseptisation des conduites**

Le lave mains est alors prêt à fonctionner

VII.2 UTILISATION

- Pour obtenir de l'eau traitée, actionner la tige plastique vers l'extérieur du bac puis relâcher. Après un temps de 5 secondes environ, l'eau s'arrête de couler.
Pour obtenir un flot continu, maintenir la commande vers l'extérieur du bac.
- Pour obtenir le savon, appuyer avec le coude sur le levier.

Ces différentes opérations peuvent être effectuées plusieurs fois si nécessaire.

LAVAGE CHIRURGICAL DES MAINS :

- ✓ Laisser couler l'eau environ 30 secondes
- ✓ Mouiller les mains, les poignets et les avant-bras jusqu'aux coudes
- ✓ Savonner soigneusement les mains, les poignets et les avant-bras jusqu'aux coudes
- ✓ Rincer l'ensemble, les avant-bras maintenus surélevés au dessus du niveau des coudes
- ✓ Brosser uniquement les ongles de chaque main pendant 30 secondes à l'aide d'une brosse stérile que l'on mouille et sur laquelle on dépose un produit antiseptique
- ✓ Rincer les mains et les avant-bras.
- ✓ Procéder alors à un nouveau lavage minutieux des mains pendant 1 minute et des avant-bras pendant 30 secondes, en insistant sur chaque espace interdigital et chaque extrémité de doigts.
- ✓ Rincer soigneusement les mains paumes tenues vers le bas et maintenues au dessus du niveau des coudes
- ✓ Sécher par tamponnement

Temps : environ 6 minutes



Le lavage chirurgical des mains ne dispense pas l'utilisateur du port de gants stériles
Le lavage chirurgical des mains doit s'effectuer avec un savon fongicide et virucide.

VII.3 PRECAUTIONS

- Un choc violent peut endommager et fissurer la coque polyester. Dans ce cas, contacter aussitôt votre service maintenance pour le remplacement de la coque ou la réparation du gelcoat.
Prendre garde aux éclats de gelcoat et aux fibres de verre qui peuvent être irritants ou coupants.

VIII MAINTENANCE

Toutes les opérations de maintenance sur les lave mains modèles S1.FM et/ou S2.FM, S2x2.FM doivent être effectuées en tenant compte des normes usuelles de sécurité.

Pour accéder directement aux pièces fixées sur le bac, retirer les 2 vis latérales hautes et desserrer les deux vis latérales basses. Dévisser le siphon. Basculer le bac vers l'avant pour l'incliner. Le bac est alors retenu par une ou deux chaînettes.

Une maintenance adéquate constitue le facteur déterminant pour garantir une prestation et une durée de vie optimum de la machine dans des conditions réelles de sécurité.

Option capotage :

En cas d'option capotage, desserrer les 2 vis latérales du capot. Faire basculer le capot ; celui-ci est alors retenu par deux chaînettes. Puis procéder au basculement du bac comme indiqué au paragraphe précédent.

VIII.1 FILTRATION

VIII.1.1 REMPLACEMENT DU PREFILTRE

- Fermer le robinet d'isolement
- Appuyer sur le bouton de purge rouge
- Dévisser le corps du carter bleu
- Remplacer la cartouche de préfiltration
- Revisser le corps du carter bleu sur la tête
- Ouvrir le robinet d'isolement
- Appuyer sur le bouton de purge rouge et maintenir la pression jusqu'à l'apparition d'eau au niveau du vis de purge.

VIII.1.2 STERILISATION ET REMPLACEMENT DU FILTRE (option)

- Soulever la bague du coupleur et enlever le filtre
- Enlever le bouchon de l'évent situé en haut du filtre
- Retourner le filtre afin de le vider et le secouer plusieurs fois
- Souffler l'intérieur du filtre à l'air comprimé en ne dépassant pas 6 bars de pression
- Remettre le bouchon de l'évent
- Cocher la case suivante sur la collerette
- Mettre le filtre sous sachet pour l'autoclavage
- Autoclavage

Installation du filtre : Cf. § VI.6

Remplacement du filtre : Les contraintes d'autoclavage peuvent altérer l'intégrité de la membrane. Afin d'utiliser le filtre en toute sécurité il convient d'effectuer régulièrement les test d'usage et remplacer le filtre dès que nécessaire. En tout état de cause, après 45 autoclavages maximum le filtre doit être remplacé : Cf. § VI.6

VIII.2 VERIFICATIONS PERIODIQUES

VIII.2.1 NETTOYAGE DES COLS DE CYGNES

Il est recommandé de démonter une fois par mois les cols de cygne pour leur nettoyage et leur stérilisation par un procédé chimique (ou en autoclave si option col de cygne autoclavable)

VIII.2.2 SAVONNIERS

Il est recommandé de nettoyer régulièrement le distributeur avec de l'eau chaude savonneuse et de le désinfecter une fois par mois.

Ne jamais utiliser des abrasifs ou des produits contenant de la chlorine.

Eviter que le flacon ne reste vide dans le distributeur. Des périodes de non utilisation prolongées (week-ends, fermetures de services, etc.) n'entraînent aucun préjudice si le récipient est rempli.

Nettoyer une fois par an la valve d'aspiration à l'eau chaude.

Remplacer le ressort lorsque nécessaire :

- retirer l'appareil de la niche
- détacher le châssis et la pompe en les retirant du boîtier
- Pousser le levier vers l'arrière et tirer le bec du verseur du boîtier
Le mécanisme complet de la pompe est alors accessible
Attention de ne pas perdre la bille
- échanger le ressort
- remonter l'ensemble en sens inverse

N'utiliser que des pièces de rechanges originales

VIII.3 OPTION ASEPTISATION DES CONDUITES

Le lave-mains chirurgical peut être équipé, en option, d'un dispositif d'aseptisation des conduites.

Il est important de désinfecter les canalisations 1 à 2 fois par semaine avec un désinfectant de type « HYSIUM ».

Le dispositif est monté sur le dessus du bac afin de faciliter l'accès.


Pour réaliser la désinfection, voir la notice « Hysium » ci-jointe.

En résumé :

- Faire couler l'eau puis appuyer sur les coupleurs (les deux en même temps)
- Enlever l'aseptiseur de son embase et dévisser le bouchon à la main
En cas de difficultés: purger en appuyant sur la partie blanche des deux coupleurs
- Verser dans la cuve une dose d' « HYSIUM »
- Revisser le bouchon en serrant pour assurer l'étanchéité et remettre l'aseptiseur sur son embase
- Attendre l'apparition de l'eau colorée
- Arrêter l'écoulement de l'eau et laisser en contact au minimum 30 minutes.

VIII.4 MELANGEUR THERMOSTATIQUE

Dévisser la vis de blocage suffisamment pour que le bouton puisse se dégager de la première rangée de cannelures, régler la température de sortie avec le bouton en position haute. Après réglage, repousser le bouton dans ses cannelures et revisser la vis de blocage.

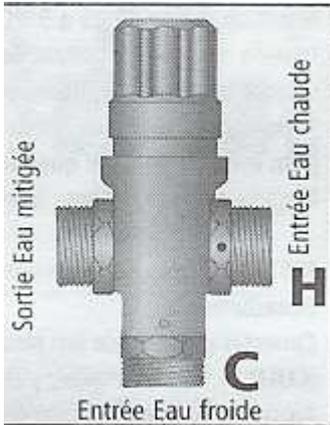

VIII.5 CONTRE-INDICATIONS DE MAINTENANCE

Les produits pouvant amener une corrosion ou l'obstruction des circuits internes de nos lave mains sont à proscrire. Nous ne pouvons, dans ce cas, maintenir notre garantie.